



---

# Ceník

---

**BioCam<sup>®</sup>**



## Frézované konstrukce

Technologie BioCam® nabízí zhotovení přesných frézovaných konstrukcí umožňující fixaci náhrady přímo do dentálních implantátů. Je k dispozici pro implantologické systémy LASAK BioniQ® a IMPLADENT® a vybrané systémy třetích stran. Konstrukce zhotovujeme z dodaných elektronických dat (BioCam® STL) nebo z dodaného sádrového modelu (BioCam® PRECISION).



### BioCam® – Ti, CoCr

vč. DPH

|  |     |             |
|--|-----|-------------|
| Šroubovaný můstek (člen nesený implantátem)            | D02 | 2.455 Kč    |
| Šroubovaný můstek (mezičlen)                           | D01 | 606 Kč      |
| Šroubovaný můstek (člen nesený pilířem LASAK)          | D06 | 742 Kč      |
| Šroubovaný můstek (člen nesený pilířem třetích stran)* | D23 | 1.484 Kč    |
| Individuální abutment                                  | D03 | 2.455 Kč    |
| Individuální abutment (frézovaný z premillu)**         | D22 | 1.450 Kč    |
| Skeletová náhrada (titan)                              | D18 | 2.500 Kč    |
| Skeletová náhrada (CoCr)                               | D19 | 3.500 Kč    |
| Kapny nebo cementované mosty (na zuby/abutmenty)       | D05 | 606 Kč/člen |

D06 je k dispozici pro pilíře Screw-On systému LASAK BioniQ® a pro pilíře pro šroubované náhrady systému LASAK IMPLADENT® s výjimkou TS pilířů. Do vícečlenných konstrukcí, ve kterých je alespoň jedna angulovaná šachta, dodáváme všechny fixační šrouby ve variantě AN, nebude-li výslovně objednáno jinak.

\* Dodáváno bez fixačního šroubu.

\*\* Dostupné pro přímou šachtu pro protetickou platformu BioniQ® QR.



### BioCam® – ZrO<sub>2</sub>

|  |     |             |
|--|-----|-------------|
| Šroubovaný můstek (člen nesený implantátem)            | D08 | 2.691 Kč    |
| Šroubovaný můstek (mezičlen)                           | D07 | 726 Kč      |
| Šroubovaný můstek (člen nesený pilířem LASAK)          | D17 | 742 Kč      |
| Šroubovaný můstek (člen nesený pilířem třetích stran)* | D24 | 1.484 Kč    |
| Individuální abutment                                  | D04 | 2.691 Kč    |
| Kapny nebo cementované mosty (na zuby/abutmenty)       | D09 | 599 Kč/člen |

Konstrukce a abutmenty z materiálu ZrO<sub>2</sub> budou doručeny s titanovými bázemi. Budou-li obsahovat alespoň jednu angulovanou šachtu, budou doručeny s bázemi Uni-Base® AN a šrouby AN, nebude-li výslovně objednáno jinak.

D17 je k dispozici pro pilíře Screw-On systému LASAK BioniQ®.

\* Dodáváno bez fixačního šroubu a bez vlepovací kapny.




### BioCam® třmeny (CEKA PRECI-HORIX / DOLDER – U, EGG / PrimeLOC) – Ti, CoCr

|   | STL             | PRECISION       |
|---|-----------------|-----------------|
| Třmen nesený 2 implantáty BAR 2                 | D11 – 7.000 Kč  | D14 – 8.272 Kč  |
| Třmen nesený 3 implantáty BAR 3                 | D12 – 10.500 Kč | D15 – 12.726 Kč |
| Třmen nesený 4 a více implantáty BAR 4          | D13 – 13.500 Kč | D16 – 16.362 Kč |
| PrimeLOC attachment pro třmeny, M2.0, sada 2 ks | A0102.S.P       | 2.850 Kč        |

### Návrh, skenování, angulace

|                           |     |             |
|---------------------------|-----|-------------|
| SCAN/CAD                  | D10 | 318 Kč/člen |
| Angulovaná šachta šroubku | D91 | 600 Kč      |



Ceny platí při dodání STL datového souboru, není-li uvedeno jinak.

V ceně konstrukce nebo abutmentu pro systémy LASAK BioniQ® a IMPLADENT®, Astra Tech®, Nobel Biocare Conical Connection, NobelReplace®, Straumann® Bone Level a synOcta® jsou zahrnuty fixační šrouby.

Pro upevnění finální náhrady použijte nový fixační šroub.

Při utahování fixačních šroubů je nutné dodržovat doporučení vydané výrobcem příslušného implantologického systému.

## FRÉZOVANÉ MOSTY A PILÍŘE BioCam®

- Vysoká přesnost
- Šetří čas a pracovní náklady
- Fixace suprakonstrukce přímo na implantáty bez dalších abutmentů
- Homogenní struktura bez defektů



## FRÉZOVANÉ SKELETY

- Vysoce přesné
- Lehké a pohodlné
- Titanová slitina / slitina CoCr
- Šetrné k okolním zubům




Ti  
2.500 Kč  
vč. DPH

# Vlepované báze Uni-Base®

Univerzální vlepované báze Uni-Base® umožňují použití plně digitálního CAD/CAM postupu i konvenčního způsobu zhotovení suprakonstrukce odléváním. Báze Uni-Base® jsou k dispozici v různých gingiválních výškách (L) a několika výškách koronární části (h) pro lepší fixaci korunky, např. při zanoření. Báze s výškou koronární části větší než 3,5 mm je možné manuálně na tuto výšku zkrátit.

Knihovny pro univerzální báze Uni-Base®, včetně knihoven manuálně zkrácených variant, jsou volně dostupné pro softwary společností exocad, 3Shape a Dental Wings na [www.lasak.cz](http://www.lasak.cz).

vč. DPH



## Báze Uni-Base® – přímé, s šestihranem

|  |   | L0.7    | L1.5    | L2.5    | L3.5    |          |
|--|---|---------|---------|---------|---------|----------|
| QR/I/d4.5/h5.5, s šestihranem – široká | ● | 2218.07 | 2218.15 | 2218.25 | 2218.35 | 1.421 Kč |
| QR/I/d4.5/h8.0, s šestihranem – široká | ● | 2225.07 | 2225.15 | 2225.25 |         | 1.421 Kč |
| QR/I/d4.5/h3.5, s šestihranem – široká | ● | 2230.07 | 2230.15 | 2230.25 |         | 1.421 Kč |
| QR/I/d3.8/h5.5, s šestihranem – úzká   | ● | 2216.07 | 2216.15 | 2216.25 |         | 1.421 Kč |
| QN/I/d3.8/h5.5, s šestihranem – úzká   | ● | 2208.07 | 2208.15 | 2208.25 | 2208.35 | 1.421 Kč |

Náhradní fixační šrouby je možné objednat pod kat. č. 2103.00 pro modrou QR protetickou platformu a pod kat. č. 2191.00 pro žlutou QN protetickou platformu.



## Báze Uni-Base® – přímé, bez šestihranu

|  |   | L0.7    | L1.5    | L2.5    |          |
|--|---|---------|---------|---------|----------|
| QR/NI/d4.5/h5.5, bez šestihranu – široká | ● | 2220.07 | 2220.15 | 2220.25 | 1.421 Kč |
| QN/NI/d4.5/h5.5, bez šestihranu – široká | ● |         | 2213.15 | 2213.25 | 1.421 Kč |


Náhradní fixační šrouby je možné objednat pod kat. č. 2103.00 pro modrou QR protetickou platformu a pod kat. č. 2191.00 pro žlutou QN protetickou platformu.



## Báze Uni-Base® – přímé, mostové

|                                  |   | L0.7    | L1.5    | L2.5    |          |
|----------------------------------|---|---------|---------|---------|----------|
| QR/B/d4.5/h5.5, mostová – široká | ● | 2221.07 | 2221.15 | 2221.25 | 1.421 Kč |
| QR/B/d4.5/h3.5, mostová – široká | ● |         | 2234.15 | 2234.25 | 1.421 Kč |

Náhradní fixační šrouby je možné objednat pod kat. č. 2103.00 pro modrou QR protetickou platformu.



## Fixační šrouby

|                          |       |         |        |
|--------------------------|-------|---------|--------|
| LASAK BioniQ QR/hex I.25 | ● ● ● | 2103.00 | 342 Kč |
| LASAK BioniQ QN/hex I.25 | ● ●   | 2191.00 | 342 Kč |

Fixační šrouby nelze použít do angulovaných bází Uni-Base® AN.

Vlepované báze Uni-Base® jsou dodávány včetně fixačního šroubu. Utahovací moment fixačních šroubů je 25 Ncm. Pro upevnění finální náhrady použijte nový fixační šroub.



# Vlepované báze Uni-Base® AN

Univerzální vlepované báze Uni-Base® AN umožňují zhotovení angulované šachty pro fixační šroub tak, aby ústí šachty vyšlo na vhodném místě v korunce. Design bází je navržen pro pohodlné použití plně digitálního CAD/CAM postupu zhotovení suprakonstrukce. Báze Uni-Base® AN jsou k dispozici až ve **čtyřech gingiválních výškách (L)**. Koronární část všech bází Uni-Base® AN je možné v definovaném místě zkrátit na výšku  $h = 3,5$  mm. Báze Uni-Base® AN jsou dodávány s fixačním šroubem BioniQ® AN/tx1.9, pro který je třeba použít šroubovák AN/tx1.9.

Knihovny pro univerzální báze Uni-Base® AN, včetně knihoven manuálně zkrácených variant, jsou volně dostupné pro softwary společností exocad, 3Shape a Dental Wings na [www.lasak.cz](http://www.lasak.cz).


vč. DPH



## Báze Uni-Base® AN – angulované, s šestihranem

|   | L0.7 | L1.5    | L2.5    | L3.5    |                  |
|---|------|---------|---------|---------|------------------|
| QR/I/AN/d4.5/h5.5, s šestihranem – široká | ●    | 2219.07 | 2219.15 | 2219.25 | 2219.35 1.594 Kč |
| QN/I/AN/d4.5/h5.5, s šestihranem – široká | ●    | 2211.07 | 2211.15 | 2211.25 | 1.594 Kč         |

Náhradní fixační šroub AN je možné objednat pod kat. č. 2229.00 pro modrou QR protetikou platformu a pod kat. č. 2228.00 pro žlutou QN protetikou platformu. Pro utahování šroubů je třeba použít šroubovák AN/tx1.9.



## Báze Uni-Base® AN – angulovaná, bez šestihranu

|   | L0.7 | L1.5    | L2.5    |                  |
|---|------|---------|---------|------------------|
| QR/NI/AN/d4.5/h5.5, bez šestihranu – široká | ●    | 2227.07 | 2227.15 | 2227.25 1.594 Kč |

Náhradní fixační šroub AN je možné objednat pod kat. č. 2229.00. Pro utahování šroubů je třeba použít šroubovák AN/tx1.9.



## Báze Uni-Base® AN – angulovaná, mostová

|                                     | L0.7 | L1.5    | L2.5    |                  |
|-------------------------------------|------|---------|---------|------------------|
| QR/B/AN/d4.5/h5.5, mostová – široká | ●    | 2226.07 | 2226.15 | 2226.25 1.594 Kč |


Náhradní fixační šroub AN je možné objednat pod kat. č. 2229.00. Pro utahování šroubů je třeba použít šroubovák AN/tx1.9.



## Fixační šrouby AN

|                            |             |   |         |        |
|----------------------------|-------------|---|---------|--------|
| QR/AN/tx1.9                | ● ● ● ● ● ● | B | 2229.00 | 430 Kč |
| QR/AN/tx1.9/L10.2 – vysoký | ● ● ● ● ● ● | B | 2254.00 | 430 Kč |
| QN/AN/tx1.9                | ● ● ● ● ● ● |   | 2228.00 | 430 Kč |
| QN/AN/tx1.9/L9.8 – vysoký  | ● ● ● ● ● ● |   | 2252.00 | 430 Kč |

Fixační šrouby AN nelze použít do přímých bází Uni-Base®.



## Šroubováky AN

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| Šroubovák AN – mechanický, extra krátký, AN/ISO/tx1.9/L21 | 2534.21 | 1.680 Kč |
| Šroubovák AN – mechanický, krátký, AN/ISO/tx1.9/L28       | 2534.28 | 1.680 Kč |
| Šroubovák AN – mechanický, dlouhý, AN/ISO/tx1.9/L36       | 2534.36 | 1.680 Kč |



### Fixační šrouby AN s vyšší hlavou

Pro vlepované báze Uni-Base® AN s gingiválními výškami L2.5 a L3.5 může být vhodnější zvolit fixační šroubu AN – vysoké (kat. č. 2254.00 a 2252.00). Fixační šrouby s vyšší hlavou mohou pomoci s umístěním ústí šachty šroubu na vhodném místě korunky, a/nebo mohou umožnit použití kratšího šroubováku v případech s omezeným okluzálním prostorem.

Vlepované báze Uni-Base® AN jsou dodávány včetně fixačního šroubu. Utahovací moment fixačních šroubů je 25 Ncm.

Pro upevnění finální náhrady použijte nový fixační šroub. V případě angulovaných šachet se šroubem AN/tx1.9 je dodržování tohoto pravidla obzvláště důležité.



### Skenovací tělíska

|  |  |         |          |
|--|--|---------|----------|
| BioniQ QR, s šestihranem – úzké              |  | 2876.00 | 1.241 Kč |
| BioniQ QN, s šestihranem – úzké              |  | 2877.00 | 1.241 Kč |
| BioniQ QR, s šestihranem – SOLO              |  | 2881.00 | 1.241 Kč |
| BioniQ QN, s šestihranem – SOLO              |  | 2882.00 | 1.241 Kč |
| BioniQ Screw-On – dlouhé                     |  | 2835.00 | 950 Kč   |
| IMPLADENT D3.7, s osmihranem*                |  | 1801.00 | 950 Kč   |
| IMPLADENT D2.9, s osmihranem*                |  | 1802.00 | 950 Kč   |
| IMPLADENT D5.0, s osmihranem*                |  | 1834.00 | 950 Kč   |
| IMPLADENT pro šroubované náhrady, D3.7/D2.9* |  | 1836.00 | 950 Kč   |

Skenovací tělíska jsou určena pro jedno použití.

\* Prodejce: LASAK dental s.r.o.

### Skenovací analogy pro reverzní techniku skenování



|  |  |         |          |
|--|--|---------|----------|
| Skenovací analog, BioniQ, reverzní technika, QR                  |  | 2884.00 | 700 Kč   |
| Skenovací analog, BioniQ, reverzní technika, QR, sada 5 ks       |  | 2884.05 | 2.800 Kč |
| Skenovací analog, BioniQ, reverzní technika, QN                  |  | 2883.00 | 700 Kč   |
| Skenovací analog, BioniQ, reverzní technika, QN, sada 5 ks       |  | 2883.05 | 2.800 Kč |
| Skenovací analog, BioniQ, reverzní technika, Screw-On            |  | 2885.00 | 700 Kč   |
| Skenovací analog, BioniQ, reverzní technika, Screw-On, sada 5 ks |  | 2885.05 | 2.800 Kč |

Z důvodu eliminace odlesků materiálu je potřeba na skenovací analogy před skenováním nanést skenovací sprej.


### Laboratorní komponenty



|  |  |         |          |
|--|--|---------|----------|
| Analog implantátu – 3D tisk, QR            |  | 2858.00 | 561 Kč   |
| Analog implantátu – 3D tisk, QR, sada 5 ks |  | 2858.05 | 2.245 Kč |
| Analog implantátu – 3D tisk, QN            |  | 2859.00 | 561 Kč   |
| Analog implantátu – 3D tisk, QN, sada 5 ks |  | 2859.05 | 2.245 Kč |

Analogy implantátu – 3D tisk lze použít pro zhotovení modelu prostřednictvím 3D tiskárny i pro zhotovení konvenčního sádrového modelu.

### Fixační šrouby



|  |  |         |        |
|--|--|---------|--------|
| Fixační šroub, QR                            |  | 2103.00 | 342 Kč |
| Fixační šroub, QN                            |  | 2191.00 | 342 Kč |
| Fixační šroub AN, QR/AN/tx1.9                |  | 2229.00 | 430 Kč |
| Fixační šroub AN, QR/AN/tx1.9/L10.2 – vysoký |  | 2254.00 | 430 Kč |
| Fixační šroub AN, QN/AN/tx1.9                |  | 2228.00 | 430 Kč |
| Fixační šroub AN, QN/AN/tx1.9/L9.8 – vysoký  |  | 2252.00 | 430 Kč |
| LASAK BioniQ Screw-On, hex1.25               |  | 2106.00 | 342 Kč |
| LASAK BioniQ Screw-On, AN/tx1.9              |  | 2237.00 | 430 Kč |

Utahovací moment skenovacích tělísek je 5–10 Ncm – ručně šroubovákem.


vč. DPH



## Pilíře Premill BioniQ®

|               |   |         |          |
|---------------|---|---------|----------|
| QR, NT – Ti   | ● | 2184.00 | 1.459 Kč |
| QR, NT – CoCr | ● | 2248.00 | 1.678 Kč |
| QN, NT – Ti   | ● | 2187.00 | 1.459 Kč |
| QN, NT – CoCr | ● | 2249.00 | 1.678 Kč |
| QR, AG – Ti   | ● | 2196.00 | 1.459 Kč |
| QR, AG – CoCr | ● | 2250.00 | 1.678 Kč |
| QN, AG – Ti   | ● | 2197.00 | 1.459 Kč |
| QN, AG – CoCr | ● | 2251.00 | 1.678 Kč |

Pilíř Premill AG je určen pro upínací systém Amann Girschbach, pilíř Premill NT je určen pro upínací systém nt-trading. Náhradní fixační šrouby je možné objednat pod kat. č. 2103.00 pro modrou QR protetikou platformu a pod kat. č. 2191.00 pro žlutou QN protetikou platformu.



## Pilíře BioCam® LASAK BioniQ®

|                            |   | L0.4    | L0.8    | L2      |          |
|----------------------------|---|---------|---------|---------|----------|
| QR/d3.7, s šestihranem     | ● |         | 2159.00 | 2159.20 | 1.599 Kč |
| QR/NI/d3.7, bez šestihranu | ● |         | 2186.00 | 2186.20 | 1.599 Kč |
| QR/B/d3.7, mostový         | ● | 2158.00 |         | 2158.20 | 1.599 Kč |
| QN/d3.7, s šestihranem     | ● |         | 2181.00 | 2181.20 | 1.599 Kč |
| QN/NI/d3.7, bez šestihranu | ● |         | 2189.00 | 2189.20 | 1.599 Kč |

Náhradní fixační šrouby je možné objednat pod kat. č. 2103.00 pro modrou QR protetikou platformu a pod kat. č. 2191.00 pro žlutou QN protetikou platformu.

Pilíře BioCam® slouží primárně jako náhradní díly ke dřívě zhotoveným konstrukcím. Pro nové práce je vhodnější používat báze Uni-Base®, které nabízejí větší retenci a stabilnější konstrukci.



## Vlepovaná báze Screw-On

|   |  |         |          |
|---|--|---------|----------|
| d4.6/d5.0   |  | 2207.00 | 546 Kč   |
| d4.6/d5.0, sada 5 ks (bez šroubu)                 |  | 2207.05 | 1.940 Kč |
| Šroub AN Screw-On pro fixaci konstrukce, AN/tx1.9 |  | 2237.00 | 430 Kč   |

\* Báze Screw-On je dodávána se šroubem pro fixaci konstrukce pro přímý šroubový kanál. Náhradní šroub Screw-On pro fixaci konstrukce je možné objednat pod kat. č. 2106.00.

Zelený šroub pro fixaci konstrukce AN/tx1.9 (kat. č. 2237.00) je určen do angulovaných šachet. Pro práci se šroubem AN/tx1.9 se používají šroubováky AN/tx1.9 (kat. č. 2534.21, 2534.28 a 2534.36).



## Pilíře BioCam® LASAK IMPLADENT®

|                     |   |         |          |
|---------------------|---|---------|----------|
| D3.7, s osmihranem  | ● | 1128.00 | 1.394 Kč |
| D3.7, bez osmihranu | ● | 1107.00 | 1.394 Kč |
| D2.9, s osmihranem  | ● | 1131.00 | 1.394 Kč |
| D2.9, bez osmihranu | ● | 1108.00 | 1.394 Kč |
| D5.0, s osmihranem  | ● | 125.3   | 2.150 Kč |

Prodejce: LASAK dental s.r.o.

Náhradní fixační šrouby je možné objednat pod kat. č. 552.3 pro protetikou řadu D3.7, pod kat. č. 752.3 pro protetikou řadu D2.9 a pod kat. č. 652.3 pro protetikou řadu D5.0.

Pilíře BioCam® jsou dodávány včetně fixačního šroubu.

Pro upevnění finální náhrady použijte nový fixační šroub.

Při utahování fixačních šroubů je nutné dodržovat doporučení vydané výrobcem příslušného implantologického systému.

● QR platforma, s šestihranem

● QR platforma, bez šestihranu

● QR platforma, mostový prvek

● Protetická řada 2.9

● QN platforma, s šestihranem

● QN platforma, bez šestihranu

● Protetická řada 5.0

● Protetická řada 3.7

## Pilíře BioCam® kompatibilní s Astra Tech®



|                           |         |          |
|---------------------------|---------|----------|
| ATS 3.0, indexovaný       | 9116.00 | 1.394 Kč |
| ATS 3.5/4.0, indexovaný   | 9040.00 | 1.394 Kč |
| ATS 3.5/4.0, neindexovaný | 9061.00 | 1.394 Kč |
| ATS 4.5/5.0, indexovaný   | 9041.00 | 1.394 Kč |

Prodejce: LASAK dental s.r.o.

## Pilíře BioCam® kompatibilní s NobelReplace®



|                       |         |          |
|-----------------------|---------|----------|
| NBR NP, indexovaný    | 9007.00 | 1.394 Kč |
| NBR NP, neindexovaný  | 9003.00 | 1.394 Kč |
| NBR WP, indexovaný    | 9009.00 | 1.394 Kč |
| NBR 6.0, indexovaný   | 9010.00 | 1.394 Kč |
| NBR 6.0, neindexovaný | 9006.00 | 1.394 Kč |

Prodejce: LASAK dental s.r.o.

## Pilíře BioCam® kompatibilní s Nobel Biocare Conical Connection



|                    |         |          |
|--------------------|---------|----------|
| NBA NP, indexovaný | 9048.00 | 1.394 Kč |
| NBA RP, indexovaný | 9049.00 | 1.394 Kč |

Prodejce: LASAK dental s.r.o.

## Pilíře BioCam® kompatibilní se Straumann® Bone Level



|                      |         |          |
|----------------------|---------|----------|
| SBL NC, indexovaný   | 9057.00 | 1.394 Kč |
| SBL NC, neindexovaný | 9059.00 | 1.394 Kč |
| SBL RC, indexovaný   | 9058.00 | 1.394 Kč |
| SBL RC, neindexovaný | 9060.00 | 1.394 Kč |

Prodejce: LASAK dental s.r.o.

## Pilíře BioCam® kompatibilní se Straumann® synOcta®



|                      |         |          |
|----------------------|---------|----------|
| SSO RN, indexovaný   | 9014.00 | 1.394 Kč |
| SSO RN, neindexovaný | 9012.00 | 1.394 Kč |
| SSO WN, indexovaný   | 9015.00 | 1.394 Kč |
| SSO WN, neindexovaný | 9013.00 | 1.394 Kč |

Prodejce: LASAK dental s.r.o.

























Pilíře BioCam® jsou dodávány včetně fixačního šroubu.

Pro upevnění finální náhrady použijte nový fixační šroub.

Při utahování fixačních šroubů je nutné dodržovat doporučení vydané výrobcem příslušného implantologického systému.

## Fixační šrouby



|  |  |         |        |
|--|--|---------|--------|
| LASAK BioniQ QR/hex I.25                             |   <b>B</b>  | 2103.00 | 342 Kč |
| LASAK BioniQ QN/hex I.25                             |     | 2191.00 | 342 Kč |
| LASAK BioniQ QR/AN/tx I.9                            |   <b>B</b>  | 2229.00 | 430 Kč |
| LASAK BioniQ QR/AN/tx I.9/L10.2 – vysoký             |   <b>B</b>  | 2254.00 | 430 Kč |
| LASAK BioniQ QN/AN/tx I.9                            |     | 2228.00 | 430 Kč |
| LASAK BioniQ QN/AN/tx I.9/L9.8 – vysoký              |     | 2252.00 | 430 Kč |
| LASAK BioniQ Screw-On, hex I.25                      |     | 2106.00 | 342 Kč |
| LASAK BioniQ Screw-On, AN/tx I.9                     |     | 2237.00 | 430 Kč |
| LASAK IMPLADENT D3.7*                                |    | 552.3   | 342 Kč |
| LASAK IMPLADENT D2.9                                 |    | 752.3   | 342 Kč |
| LASAK IMPLADENT, šroub pro fixaci konstrukce*        |     | 1641.3  | 342 Kč |
| Astra Tech, ATS M1.4 (pro 3.0)*                      |  | 9115.00 | 342 Kč |
| Astra Tech, ATS M1.6 (pro 3.5/4.0)*                  |  | 9038.00 | 342 Kč |
| NobelActive (Conical Connection), NBA M1.6 (pro NP)* |  | 9046.00 | 342 Kč |
| NobelActive (Conical Connection), NBA M2.0 (pro RP)* |  | 9047.00 | 342 Kč |
| NobelReplace, NBR M1.8 (pro NP)*                     |  | 9001.00 | 342 Kč |
| NobelReplace, NBR M2.0 (pro RP, WP, 6.0)*            |  | 9002.00 | 342 Kč |
| Straumann Bone Level, SBL M1.6 (pro NC)*             |  | 9033.00 | 342 Kč |
| Straumann Bone Level, SBL M1.6 (pro RC)*             |  | 9034.00 | 342 Kč |
| Straumann synOcta, SSO M1.8 (pro NN)*                |  | 9054.00 | 342 Kč |
| Straumann synOcta, SSO M2.0 (pro RN, WN)*            |  | 9011.00 | 342 Kč |
| CAMLOG, CA-CA M1.6 (pro 3.3, 3.8, 4.3)*              |  | 9209.00 | 342 Kč |
| CAMLOG, CA-CA M2.0 (pro 5.0, 6.0)*                   |  | 9210.00 | 342 Kč |

\* Prodejce: LASAK dental s.r.o.

**Pro upevnění finální náhrady v ústech pacienta vždy použijte nový fixační šroub.** Nedodržení tohoto pravidla může způsobit nadměrné opotřebení vnitřní geometrie hlavy šroubu i přes to, že bude při upevnění finální náhrady dodržen doporučený utahovací moment. Povolení šroubku v budoucnu tím může být ztíženo nebo zcela znemožněno.

## Šroubováky



|  |         |          |
|--|---------|----------|
| Šroubovák – extra krátký, hex I.25/L17                     | 2404.00 | 1.003 Kč |
| Šroubovák – krátký, hex I.25/L23                           | 2405.00 | 1.003 Kč |
| Šroubovák – dlouhý, hex I.25/L32                           | 2406.00 | 1.003 Kč |
| Šroubovák – mechanický, krátký, hex I.25/ISO/L11           | 2413.11 | 524 Kč   |
| Šroubovák – mechanický, dlouhý, hex I.25/ISO/L21           | 2413.21 | 524 Kč   |
| Šroubovák AN – mechanický, extra krátký, AN/ISO/tx I.9/L21 | 2534.21 | 1.680 Kč |
| Šroubovák AN – mechanický, krátký, AN/ISO/tx I.9/L28       | 2534.28 | 1.680 Kč |
| Šroubovák AN – mechanický, dlouhý, AN/ISO/tx I.9/L36       | 2534.36 | 1.680 Kč |

Pilíře BioCam® jsou dodávány včetně fixačního šroubu.

Při utahování fixačních šroubů je nutné dodržovat doporučení vydané výrobcem příslušného implantologického systému.

## MOŽNOSTI ZHOTOVENÍ ANGULOVANÝCH ŠACHET

| Typ konstrukce                             | Implantační systém a protetická platforma         | Tvar šachty |   | Podporované typy spojení pro angulaci | Skenovací tělísko – kat. č. | Poznámka                       |
|--|---|-------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|  |   | Přímá       | Angulovaná < 15° s originálním šroubem* |                                       |                             |                                |
| Frézované konstrukce s integrálním dosedem | BioniQ QR   | ✓           | ✓                                       | I, B, NI                              | 2876.00, 2881.00            | Příplatek za angulaci D91/člen |
|  | BioniQ QN   | ✓           | ✓                                       | NI                                    | 2877.00, 2882.00            |                                |
|  | Screw-On  | ✓           | ✓                                       | ✓                                     | 2835.00                     | Příplatek za angulaci D91/člen |
|  | IMPLADENT D2.9                                    | ✓           | ✓                                       | I, B                                  | 1802.00                     | Příplatek za angulaci D91/člen |
|  | IMPLADENT D3.7                                    | ✓           | ✓                                       | I, B                                  | 1801.00                     |                                |
|  | IMPLADENT D5.0                                    | ✓           | ✓                                       | I, B                                  | 1834.00                     | Příplatek za angulaci D91/člen |
|  | IMPLADENT pilíře pro šroubované náhrady D3.7/d4.8 | ✓           | ✓                                       | ✓                                     | 1836.00                     | Příplatek za angulaci D91/člen |
| Ostatní systémy***                         | ✓   | ✗           | ✗                                       | Scan + CAD LASAK                      | —————                       |                                |

| Typ konstrukce                        | Implantační systém a protetická platforma | Tvar šachty |  | Skenovací tělísko – kat. č. | Poznámka                       |
|---------------------------------------|---|-------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
|                                       |   | Přímá       | Angulovaná < 25° se speciálním šroubem** |                             |                                |
| Frézované konstrukce na báze Uni-Base | BioniQ QR                                 | ✓           | ✓  | 2876.00, 2881.00            | Příplatek za angulaci D91/člen |
|                                       | BioniQ QN                                 | ✓           | ✓  | 2877.00, 2882.00            | Příplatek za angulaci D91/člen |
| Frézované konstrukce na pilíře BioCam | BioniQ QR                                 | ✓           | ✗  | 2876.00, 2881.00            | —————                          |
|                                       | BioniQ QN                                 | ✓           | ✗  | 2877.00, 2882.00            | —————                          |
|                                       | Screw-On                                  | ✓           | ✓  | 2835.00                     | Příplatek za angulaci D91/člen |
|                                       | IMPLADENT D2.9                            | ✓           | ✗  | 1802.00                     | —————                          |
|                                       | IMPLADENT D3.7                            | ✓           | ✗  | 1801.00                     | —————                          |
|                                       | IMPLADENT D5.0                            | ✓           | ✗  | 1834.00                     | —————                          |
| Ostatní systémy***                    | ✓   | ✗           | Scan + CAD LASAK                         | —————                       |                                |

\* Fixační šrouby QR s kat. č. 2103.00, QN s kat. č. 2191.00 a šroub Screw-On pro fixaci konstrukce s kat. č. 2106.00. Pro práci se šrouby se používá šroubovák hex I.25.  
 \*\* AN fixační šrouby QR s kat. č. 2229.00, QN s kat. č. 2228.00 a šroub Screw-On pro fixaci konstrukce s kat. č. 2237.00. Pro práci se šrouby se používají šroubováky AN/tx I.9 s kat. č. 2534.21, 2534.28 a 2534.36.

\*\*\* Implantologické systémy, na které je možné objednávat frézované konstrukce, jsou uvedené v tabulce kompatibility na [www.lasak.cz](http://www.lasak.cz).

Mostové konstrukce, ve kterých je alespoň jedna šachta angulovaná, budou dodané se všemi bázemi Uni-Base® AN a fixačními šrouby AN, nebude-li výslovně objednáno jinak. Pro re-design dosedů je třeba zaslat STL data (pracovní model s konstrukcí a dáseň) na e-mail [cadcam@lasak.cz](mailto:cadcam@lasak.cz) a sádrový pracovní model poštou do společnosti LASAK.

## DOBA ZHOTOVENÍ A DODÁNÍ FRÉZOVANÝCH KONSTRUKCÍ BioCam®

Příklady standardní doby zhotovení a dodání frézovaných konstrukcí BioCam® pro různé druhy konstrukcí. V uvedeném příkladu je objednávka doručena do společnosti LASAK v pondělí. Objednávky přijímáme každý pracovní den.


|   |                         | PONDĚLÍ              | ÚTERÝ | STŘEDA     | ČTVRTEK | PÁTEK      | PONDĚLÍ    |
|---|-------------------------|----------------------|-------|------------|---------|------------|------------|
| šroubované konstrukce                       | INDIVIDUÁLNÍ ABUTMENTY  | Zhotovení konstrukce |       | doručování |         |            |            |
|   | KONSTRUKCE DO 4 ČLENŮ   | Zhotovení konstrukce |       | doručování |         |            |            |
|   | TŘMENY*                 | Zhotovení konstrukce |       |            |         | doručování |            |
|   | KONSTRUKCE OD 5 ČLENŮ** | Zhotovení konstrukce |       |            |         |            | doručování |
| cementované konstrukce                      | KONSTRUKCE DO 4 ČLENŮ   | Zhotovení konstrukce |       | doručování |         |            |            |
|   | KONSTRUKCE OD 5 ČLENŮ*  | Zhotovení konstrukce |       |            |         | doručování |            |
| SCAN/CAD                                    |                         | + 24 hodin           |       |            |         |            |            |
| ANGULOVANÁ ŠACHTA ŠROUBKU                   |                         | + 72 hodin           |       |            |         |            |            |
| * EXPRESNÍ ZHOTOVENÍ (+ 20 % CENY ZAKÁZKY)  |                         |                      |       |            |         | - 24 hodin |            |
| ** EXPRESNÍ ZHOTOVENÍ (+ 20 % CENY ZAKÁZKY) |                         | - 48 hodin           |       |            |         |            |            |

Pokud není doprava při objednávce dohodnuta jinak, standardní způsob dodání přepravní společností je do dvou pracovních dnů. Při expresním zhotovení konstrukce je zakázka vždy odeslána expresním dopoledním doručením, tedy do druhého dne. Po výstupní kontrole bude zákazník informován o odeslání nebo možnosti vyzvednutí zakázky.

## ONLINE SYSTÉM OBJEDNÁVEK

Frézované konstrukce můžete objednávat také prostřednictvím našeho online systému. Pohodlně, rychle a efektivně.

[www.lasak.cz/produkty/biocam/objednavka](http://www.lasak.cz/produkty/biocam/objednavka)

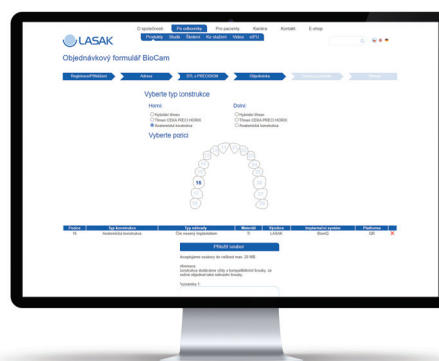

## VZDÁLENÁ PODPORA

Máte potíže nebo si nevíte rady s instalací nebo nastavením CAD knihovny LASAK? Díky aplikaci Anydesk to můžete nechat na nás. Podpora je k dispozici po-pá pouze po předchozí domluvě s naším operátorem na tel. číslo +420 734 230 957.

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Společnost LASAK tímto zaručuje, že pokud výrobce implantátu jako třetí osoba odmítne výměnu implantátu na základě údajné neúspěšnosti z důvodu použití individuálních řešení společnosti LASAK frézovaných metodou CAD/CAM, a to do 10 let po implantaci, poskytne společnost LASAK implantát i pilíř zdarma. Společnost LASAK dále zaručuje, že v případě vadného výrobku LASAK v důsledku vady pevnosti a stálosti materiálu výrobku v průběhu záručních lhůt (záruka 10 let na konstrukce vyrobené z titanu nebo slitiny CoCr, záruka 5 let na konstrukce ze ZrO<sub>2</sub>) společnost LASAK tento výrobek vymění za stejný nebo rovnocenný výrobek. Podmínky záruky jsou blíže popsány v Záruce LASAK.

V uvedených cenách není zahrnuta doprava. Uvedené ceny jsou vč. DPH a jsou platné od 1. 5. 2026.

### KONTAKT / OBJEDNÁVKY

Telefon: +420 224 315 663, e-mail: [cadcam@lasak.cz](mailto:cadcam@lasak.cz)

Poštovní adresa: LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, Hloubětín, 190 00 Praha 9

Použité obrázky věrně zobrazují dané výrobky. LASAK s.r.o. si vyhrazuje právo své výrobky modifikovat, ukončit jejich výrobu nebo změnit jejich specifikaci a cenu bez předchozího upozornění. V důsledku toho se mohou reálné výrobky od vyobrazených odlišovat provedením nebo barevným odstínem. Použité obrázky nezobrazují výrobky v reálné velikosti, není-li výslovně uvedeno jinak.

Astra Tech® je registrovaná obchodní známka Dentsply Sirona Inc., USA. NobelActive® a NobelReplace® jsou registrované obchodní známky Nobel Biocare Holding AG, Switzerland. Straumann® a synOcta® jsou registrované obchodní známky Straumann Holding AG, Switzerland. CAMLOG® je registrovaná obchodní známka CAMLOG Biotechnologies AG, Switzerland. PrimeLOC je ochranná známka společnosti MEDEALIS GmbH, Deutschland.

# Rejstřík katalogových čísel

| Kat.č.  | Název  | Specifikace            | Strana  |
|---------|--|------------------------|---------|
| 125.3   | Pilíř STANDARD – přímý                               | D5.0/L1                | 7       |
| 1801.00 | Skenovací tělísko, IMPLADENT, s osmihranem           | D3.7                   | 6       |
| 1802.00 | Skenovací tělísko, IMPLADENT, s osmihranem           | D2.9                   | 6       |
| 1834.00 | Skenovací tělísko, IMPLADENT, s osmihranem           | D5.0                   | 6       |
| 1836.00 | Skenovací tělísko, IMPLADENT, pro šroubované náhrady | D3.7/D2.9              | 6       |
| 2103.00 | Fixační šroub, BioniQ                                | QR/hex I .25           | 4, 6, 9 |
| 2106.00 | Šroub Screw-On pro fixaci konstrukce                 | hex I .25              | 6, 9    |
| 2158.00 | Pilíř BioCam, BioniQ, mostový                        | QR/B/d3.7/L0.4         | 7       |
| 2158.20 | Pilíř BioCam, BioniQ, mostový                        | QR/B/d3.7/L2.0         | 7       |
| 2159.00 | Pilíř BioCam, BioniQ, s šestihranem                  | QR/d3.7/L0.8           | 7       |
| 2159.20 | Pilíř BioCam, BioniQ, s šestihranem                  | QR/d3.7/L2.0           | 7       |
| 2181.00 | Pilíř BioCam, BioniQ, s šestihranem                  | QN/d3.7/L0.8           | 7       |
| 2181.20 | Pilíř BioCam, BioniQ, s šestihranem                  | QN/d3.7/L2.0           | 7       |
| 2184.00 | Pilíř Premill, BioniQ, NT – Ti                       | QR/d I 2               | 7       |
| 2186.00 | Pilíř BioCam, BioniQ, bez šestihranu                 | QR/NI/d3.7/L0.8        | 7       |
| 2186.20 | Pilíř BioCam, BioniQ, bez šestihranu                 | QR/NI/d3.7/L2.0        | 7       |
| 2187.00 | Pilíř Premill, BioniQ, NT – Ti                       | QN/d I 2               | 7       |
| 2189.00 | Pilíř BioCam, BioniQ, bez šestihranu                 | QN/NI/d3.7/L0.8        | 7       |
| 2189.20 | Pilíř BioCam, BioniQ, bez šestihranu                 | QN/NI/d3.7/L2.0        | 7       |
| 2191.00 | Fixační šroub, BioniQ                                | QN/hex I .25           | 4, 6, 9 |
| 2196.00 | Pilíř Premill, BioniQ, AG – Ti                       | QR/d I 2               | 7       |
| 2197.00 | Pilíř Premill, BioniQ, AG – Ti                       | QN/d I 2               | 7       |
| 2207.00 | Báze BioCam, BioniQ, Screw-On                        | d4.6/d5.0/h5.0/L0.4    | 7       |
| 2207.05 | Báze BioCam, BioniQ, Screw-On, sada 5 ks             | d4.6/d5.0/h5.0/L0.4    | 7       |
| 2208.07 | Uni-Base, BioniQ, s šestihranem, úzká                | QN/d3.8/h5.5/L0.7      | 4       |
| 2208.15 | Uni-Base, BioniQ, s šestihranem, úzká                | QN/d3.8/h5.5/L1.5      | 4       |
| 2208.25 | Uni-Base, BioniQ, s šestihranem, úzká                | QN/d3.8/h5.5/L2.5      | 4       |
| 2208.35 | Uni-Base, BioniQ, s šestihranem, úzká                | QN/d3.8/h5.5/L3.5      | 4       |
| 2211.07 | Uni-Base AN, BioniQ, s šestihranem, široká           | QN/AN/d4.5/h5.5/L0.7   | 5       |
| 2211.15 | Uni-Base AN, BioniQ, s šestihranem, široká           | QN/AN/d4.5/h5.5/L1.5   | 5       |
| 2211.25 | Uni-Base AN, BioniQ, s šestihranem, široká           | QN/AN/d4.5/h5.5/L2.5   | 5       |
| 2213.15 | Uni-Base, BioniQ, bez šestihranu, široká             | QN/NI/d4.5/h5.5/L1.5   | 4       |
| 2213.25 | Uni-Base, BioniQ, bez šestihranu, široká             | QN/NI/d4.5/h5.5/L2.5   | 4       |
| 2216.07 | Uni-Base, BioniQ, s šestihranem, úzká                | QR/d3.8/h5.5/L0.7      | 4       |
| 2216.15 | Uni-Base, BioniQ, s šestihranem, úzká                | QR/d3.8/h5.5/L1.5      | 4       |
| 2216.25 | Uni-Base, BioniQ, s šestihranem, úzká                | QR/d3.8/h5.5/L2.5      | 4       |
| 2218.07 | Uni-Base, BioniQ, s šestihranem, široká              | QR/d4.5/h5.5/L0.7      | 4       |
| 2218.15 | Uni-Base, BioniQ, s šestihranem, široká              | QR/d4.5/h5.5/L1.5      | 4       |
| 2218.25 | Uni-Base, BioniQ, s šestihranem, široká              | QR/d4.5/h5.5/L2.5      | 4       |
| 2218.35 | Uni-Base, BioniQ, s šestihranem, široká              | QR/d4.5/h5.5/L3.5      | 4       |
| 2219.07 | Uni-Base AN, BioniQ, s šestihranem, široká           | QR/AN/d4.5/h5.5/L0.7   | 5       |
| 2219.15 | Uni-Base AN, BioniQ, s šestihranem, široká           | QR/AN/d4.5/h5.5/L1.5   | 5       |
| 2219.25 | Uni-Base AN, BioniQ, s šestihranem, široká           | QR/AN/d4.5/h5.5/L2.5   | 5       |
| 2219.35 | Uni-Base AN, BioniQ, s šestihranem, široká           | QR/AN/d4.5/h5.5/L3.5   | 5       |
| 2220.07 | Uni-Base, BioniQ, bez šestihranu, široká             | QR/NI/d4.5/h5.5/L0.7   | 4       |
| 2220.15 | Uni-Base, BioniQ, bez šestihranu, široká             | QR/NI/d4.5/h5.5/L1.5   | 4       |
| 2220.25 | Uni-Base, BioniQ, bez šestihranu, široká             | QR/NI/d4.5/h5.5/L2.5   | 4       |
| 2221.07 | Uni-Base, BioniQ, mostová, široká                    | QR/B/d4.5/h5.5/L0.7    | 4       |
| 2221.15 | Uni-Base, BioniQ, mostová, široká                    | QR/B/d4.5/h5.5/L1.5    | 4       |
| 2221.25 | Uni-Base, BioniQ, mostová, široká                    | QR/B/d4.5/h5.5/L2.5    | 4       |
| 2225.07 | Uni-Base, BioniQ, s šestihranem, široká              | QR/d4.5/h8.0/L0.7      | 4       |
| 2225.15 | Uni-Base, BioniQ, s šestihranem, široká              | QR/d4.5/h8.0/L1.5      | 4       |
| 2225.25 | Uni-Base, BioniQ, s šestihranem, široká              | QR/d4.5/h8.0/L2.5      | 4       |
| 2226.07 | Uni-Base AN, BioniQ, mostová, široká                 | QR/B/AN/d4.5/h5.5/L0.7 | 5       |

# Rejstřík katalogových čísel

| Kat.č.  | Název  | Specifikace             | Strana  |
|---------|--|-------------------------|---------|
| 2226.15 | Uni-Base AN, BioniQ, mostová, široká                   | QR/B/AN/d4.5/h5.5/L1.5  | 5       |
| 2226.25 | Uni-Base AN, BioniQ, mostová, široká                   | QR/B/AN/d4.5/h5.5/L2.5  | 5       |
| 2227.07 | Uni-Base AN, BioniQ, bez šestihranu, široká            | QR/Ni/AN/d4.5/h5.5/L0.7 | 5       |
| 2227.15 | Uni-Base AN, BioniQ, bez šestihranu, široká            | QR/Ni/AN/d4.5/h5.5/L1.5 | 5       |
| 2227.25 | Uni-Base AN, BioniQ, bez šestihranu, široká            | QR/Ni/AN/d4.5/h5.5/L2.5 | 5       |
| 2228.00 | Fixační šroub AN, BioniQ                               | QN/AN/tx1.9             | 5, 7, 9 |
| 2229.00 | Fixační šroub AN, BioniQ                               | QR/AN/tx1.9             | 5, 7, 9 |
| 2230.07 | Uni-Base, BioniQ, s šestihranem, široká                | QR/d4.5/h3.5/L0.7       | 4       |
| 2230.15 | Uni-Base, BioniQ, s šestihranem, široká                | QR/d4.5/h3.5/L1.5       | 4       |
| 2230.25 | Uni-Base, BioniQ, s šestihranem, široká                | QR/d4.5/h3.5/L2.5       | 4       |
| 2234.15 | Uni-Base, BioniQ, mostová, široká                      | QR/B/d4.5/h3.5/L1.5     | 4       |
| 2234.25 | Uni-Base, BioniQ, mostová, široká                      | QR/B/d4.5/h3.5/L2.5     | 4       |
| 2237.00 | Šroub AN Screw-On pro fixaci konstrukce                | AN/tx1.9                | 6, 7, 9 |
| 2248.00 | Pilíř Premill, BioniQ, NT – CoCr                       | QR/d12                  | 7       |
| 2249.00 | Pilíř Premill, BioniQ, NT – CoCr                       | QN/d12                  | 7       |
| 2250.00 | Pilíř Premill, BioniQ, AG – CoCr                       | QR/d12                  | 7       |
| 2251.00 | Pilíř Premill, BioniQ, AG – CoCr                       | QN/d12                  | 7       |
| 2252.00 | Fixační šroub AN, BioniQ – vysoký                      | QN/AN/tx1.9/L9.8        | 5, 7, 9 |
| 2254.00 | Fixační šroub AN, BioniQ – vysoký                      | QR/AN/tx1.9/L10.2       | 5, 7, 9 |
| 2404.00 | Šroubovák – extra krátký                               | hex1.25/L8/L17          | 9       |
| 2405.00 | Šroubovák – krátký                                     | hex1.25/L12/L23         | 9       |
| 2406.00 | Šroubovák – dlouhý                                     | hex1.25/L21/L32         | 9       |
| 2413.11 | Šroubovák – mechanický, krátký                         | hex1.25/ISO/L11         | 9       |
| 2413.21 | Šroubovák – mechanický, dlouhý                         | hex1.25/ISO/L21         | 9       |
| 2534.21 | Šroubovák AN – mechanický, extra krátký                | AN/ISO/tx1.9/L21        | 5, 9    |
| 2534.28 | Šroubovák AN – mechanický, krátký                      | AN/ISO/tx1.9/L28        | 5, 9    |
| 2534.36 | Šroubovák AN – mechanický, dlouhý                      | AN/ISO/tx1.9/L36        | 5, 9    |
| 2835.00 | Skenovací tělísko, BioniQ, Screw-On – dlouhé           | d4.6                    | 6       |
| 2858.00 | Analog implantátu – 3D tisk                            | QR/4.0                  | 6       |
| 2858.05 | Analog implantátu – 3D tisk, sada 5 ks                 | QR/4.0                  | 6       |
| 2859.00 | Analog implantátu – 3D tisk                            | QN/2.9                  | 6       |
| 2859.05 | Analog implantátu – 3D tisk, sada 5 ks                 | QN/2.9                  | 6       |
| 2860.00 | Analog pilíře Screw-On – 3D tisk                       | d4.6                    | 6       |
| 2876.00 | Skenovací tělísko, BioniQ, s šestihranem – úzké        | QR                      | 6       |
| 2877.00 | Skenovací tělísko, BioniQ, s šestihranem – úzké        | QN                      | 6       |
| 2881.00 | Skenovací tělísko, BioniQ, s šestihranem – SOLO        | QR                      | 6       |
| 2882.00 | Skenovací tělísko, BioniQ, s šestihranem – SOLO        | QN                      | 6       |
| 2883.00 | Skenovací analog, BioniQ, reverzní technika            | QN/d3.5                 | 6       |
| 2883.05 | Skenovací analog, BioniQ, reverzní technika, sada 5 ks | QN/d3.5                 | 6       |
| 2884.00 | Skenovací analog, BioniQ, reverzní technika            | QR/d4.0                 | 6       |
| 2884.05 | Skenovací analog, BioniQ, reverzní technika, sada 5 ks | QR/d4.0                 | 6       |
| 2885.00 | Skenovací analog, BioniQ, reverzní technika            | Screw-On/d4.6           | 6       |
| 2885.05 | Skenovací analog, BioniQ, reverzní technika, sada 5 ks | Screw-On/d4.6           | 6       |
| 9001.00 | Fixační šroub, NobelReplace, NBR                       | NP/M1.8                 | 9       |
| 9002.00 | Fixační šroub, NobelReplace, NBR                       | RP/WP/6.0/M2.0          | 9       |
| 9003.00 | Pilíř BioCam, NBR, neindexovaný                        | NP                      | 8       |
| 9006.00 | Pilíř BioCam, NBR, neindexovaný                        | 6.0                     | 8       |
| 9007.00 | Pilíř BioCam, NBR, indexovaný                          | NP                      | 8       |
| 9009.00 | Pilíř BioCam, NBR, indexovaný                          | WP                      | 8       |
| 9010.00 | Pilíř BioCam, NBR, indexovaný                          | 6.0                     | 8       |
| 9011.00 | Fixační šroub, Straumann synOcta, SSO                  | RN/WN/M2.0              | 9       |
| 9012.00 | Pilíř BioCam, SSO, neindexovaný                        | RN                      | 8       |
| 9013.00 | Pilíř BioCam, SSO, neindexovaný                        | WN                      | 8       |
| 9014.00 | Pilíř BioCam, SSO, indexovaný                          | RN                      | 8       |

# Rejstřík katalogových čísel

| Kat.č.    | Název   | Specifikace      | Strana |
|-----------|---|------------------|--------|
| 9015.00   | Pilíř BioCam, SSO, indexovaný   | WN               | 8      |
| 9033.00   | Fixační šroub, Straumann Bone Level, SBL                                    | NC/M1.6          | 9      |
| 9034.00   | Fixační šroub, Straumann Bone Level, SBL                                    | RC/M1.6          | 9      |
| 9038.00   | Fixační šroub, Astra Tech, ATS  | 3.5/4.0/M1.6     | 9      |
| 9040.00   | Pilíř BioCam, ATS, indexovaný   | 3.5/4.0          | 8      |
| 9041.00   | Pilíř BioCam, ATS, indexovaný   | 4.5/5.0          | 8      |
| 9046.00   | Fixační šroub, NobelActive, NBA   | NP/M1.6          | 9      |
| 9047.00   | Fixační šroub, NobelActive, NBA   | RP/M2.0          | 9      |
| 9048.00   | Pilíř BioCam, NBA, indexovaný   | NP               | 8      |
| 9049.00   | Pilíř BioCam, NBA, indexovaný   | RP               | 8      |
| 9054.00   | Fixační šroub, Straumann synOcta, SSO                                       | NN/M1.8          | 9      |
| 9055.00   | Pilíř BioCam, SSO, indexovaný   | NN               | 8      |
| 9057.00   | Pilíř BioCam, SBL, indexovaný   | NC               | 8      |
| 9058.00   | Pilíř BioCam, SBL, indexovaný   | RC               | 8      |
| 9059.00   | Pilíř BioCam, SBL, neindexovaný   | NC               | 8      |
| 9060.00   | Pilíř BioCam, SBL, neindexovaný   | RC               | 8      |
| 9061.00   | Pilíř BioCam, ATS, neindexovaný   | 3.5/4.0          | 8      |
| 9115.00   | Fixační šroub, Astra Tech, ATS  | 3.0/M1.4         | 9      |
| 9116.00   | Pilíř BioCam, ATS, indexovaný – úzký  | 3                | 8      |
| 9164.00   | Pilíř BioCam, SSO, indexovaný – úzký  | NN               | 8      |
| 9209.00   | Fixační šroub, CAMLOG, CA-CA  | 3.3/3.8/4.3/M1.6 | 9      |
| 9210.00   | Fixační šroub, CAMLOG, CA-CA  | 5.0/6.0/M2.0     | 9      |
| 9300.00   | Pilíř Cast-On, NBR, indexovaný  | RP               | 8      |
| 9302.00   | Pilíř Cast-On, SSO, indexovaný  | RN               | 8      |
| 9306.00   | Pilíř Cast-On, NBR, indexovaný  | NP               | 8      |
| 9312.00   | Pilíř Cast-On, NBA, indexovaný  | NP               | 8      |
| 9313.00   | Pilíř Cast-On, NBA, indexovaný  | RP               | 8      |
| 9328.00   | Pilíř Cast-On, SSO, neindexovaný  | WN               | 8      |
| A0102.S.P | Attachment PrimeLOC pro třmeny, M2.0, sada 2 ks                             | M2.0             | 2      |
| D01       | Mezičlen šroubovaného mostu nad dva implantáty, kov                         |                  | 2      |
| D02       | Člen nesený implantátem, kov  |                  | 2      |
| D03       | Individuální pilíř BioCam, kov  |                  | 2      |
| D04       | Individuální pilíř BioCam, ZrO <sub>2</sub>                                 |                  | 2      |
| D05       | Mezičlen/kapna  |                  | 2      |
| D06       | Člen nesený pilířem pro šroubované náhrady                                  |                  | 2      |
| D07       | Mezičlen mostu, ZrO <sub>2</sub>  |                  | 2      |
| D08       | Člen nesený implantátem, ZrO <sub>2</sub>                                   |                  | 2      |
| D09       | Mezičlen kapna, ZrO <sub>2</sub>  |                  | 2      |
| D10       | Skenování a design  |                  | 2      |
| D11       | BAR 2 STL - třmen nesený 2 implantáty                                       | Ceka Preci-Horix | 2      |
| D12       | BAR 3 STL - třmen nesený 3 implantáty                                       | Ceka Preci-Horix | 2      |
| D13       | BAR 4 STL - třmen nesený 4 a více implantáty                                | Ceka Preci-Horix | 2      |
| D14       | BAR 2 PRECISION - třmen nesený 2 implantáty                                 | Ceka Preci-Horix | 2      |
| D15       | BAR 3 PRECISION - třmen nesený 3 implantáty                                 | Ceka Preci-Horix | 2      |
| D16       | BAR 4 PRECISION - třmen nesený 4 a více implantáty                          | Ceka Preci-Horix | 2      |
| D17       | Člen nesený pilířem pro šroubované náhrady, ZrO <sub>2</sub>                |                  | 2      |
| D18       | Skeletová náhrada, Ti   |                  | 2      |
| D19       | Skeletová náhrada, CoCr   |                  | 2      |
| D22       | Individuální pilíř BioCam z premillu, titan                                 |                  | 2      |
| D23       | Člen nesený pilířem pro šroubované náhrady cizího systému                   |                  | 2      |
| D24       | Člen nesený pilířem pro šroubované náhrady cizího systému, ZrO <sub>2</sub> |                  | 2      |
| D91       | Angulovaná šachta šroubku - integrální konstrukce                           |                  | 2      |



IFU-000105 Rev,[26] 2026-05-01



**LASAK s.r.o.** • Českobrodská 1047/46 • Hloubětín, 190 00 Praha 9  
tel.: +420 224 315 663 • e-mail: [objednavky@lasak.cz](mailto:objednavky@lasak.cz) • [www.lasak.cz](http://www.lasak.cz)